

Cese de utilización y retirada del mercado del lote R1033A de la solución oftálmica Optiben Ojos Secos 10ml

Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2022

Categoría: productos sanitarios

Referencia: PS, 40/2022

- **La AEMPS informa del cese de utilización y de la retirada del mercado del lote R1033A de la solución oftálmica Optiben Ojos Secos 10ml fabricada por Avizor SA, España**
- **El envase del lote R1033A podría contener un producto diferente utilizado para los exámenes de fondo de ojo cuya aplicación puede provocar reacciones alérgicas, visión borrosa, irritación, etc**
- **La Agencia establece una serie de recomendaciones de cómo actuar para distribuidores y pacientes**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del fabricante Avizor SA, España, del cese de utilización y de la retirada del mercado de la solución oftálmica Optiben Ojos Secos 10ml con número de lote R1033A.

Optiben Ojos Secos es una solución oftálmica para la humectación y lubricación del ojo como el alivio de la sensación de sequedad y las irritaciones oculares ocasionadas por las condiciones ambientales, el cansancio, el trabajo prolongado frente a dispositivos digitales o el uso de lentes de contacto.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, se ha detectado que el envase del lote afectado de Optiben Ojos Secos (lote R1033A) puede contener un producto diferente, en concreto Methocel Alemania 3x10gr número de lote R1086A. Este producto se utiliza como solución de contacto entre el ojo y la lente de uso diagnóstico en el examen de fondo de ojo con lámpara de hendidura, en gonioscopía o determinados tratamientos oculares.

El uso inadvertido de Methocel en lugar de Optiben podría provocar una reacción alérgica en el paciente, además de visión borrosa transitoria debido a la diferente viscosidad de ambos productos, entre otros tipos de efectos adversos como enrojecimiento, irritación, escozor, etc.

Optiben Ojos Secos se distribuye en España a través de la empresa Laboratorios Cinfa (Travesía de Roncesvalles, 31699 Polígono de Olloki, Navarra).

Situación actual en España

La empresa está enviando, a través de sus distribuidores en España, una [nota de aviso](#) a los pacientes, establecimientos de venta y distribución, que disponen del producto afectado, para informarles del problema identificado y de las acciones a seguir para la retirada del producto.

Productos afectados

Optiben ojos secos 10ml número de lote R1033A (figura 1 y 2).



Figura 1. Posición del número de lote en el envase de Optiben Ojos Secos 10 ml.

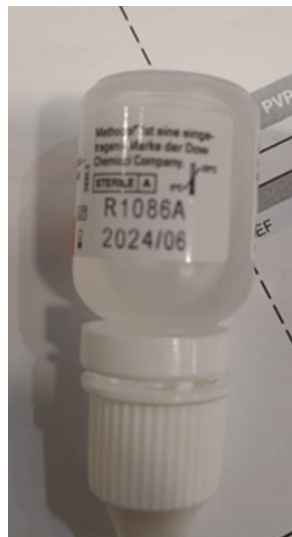


Figura 2. Imagen del envase de Methocel que se podría encontrar erróneamente en el envase del lote afectado de Optiben Ojos Secos.